

FLEXODUCT® Medical



Kirugisk røgsug



Procesudsug fra
El - kirurgi og laserkirurgi



Udviklet iht. At vejledning om krav til ventilation på faste arbejdssteder A.1.1



JRV A/S - Flexoduct Medical
Nimbusvej 10 - DK 2670 Greve
Tlf. 43 950 950 Fax. 43 950 951
sales@jrv.dk www.jrv.dk




FLEXODUCT® Medical

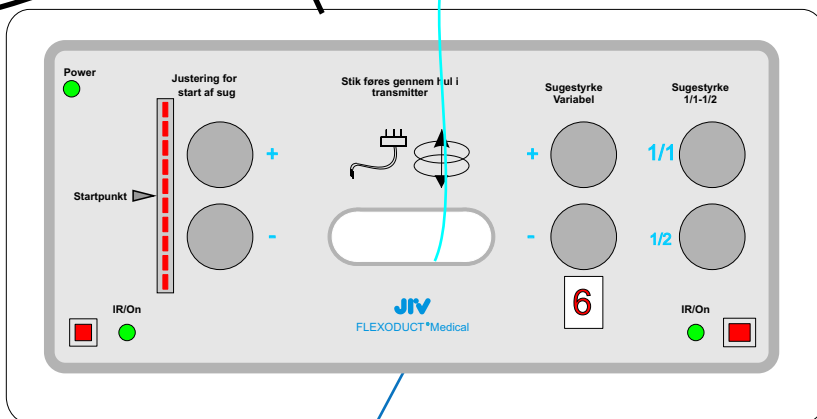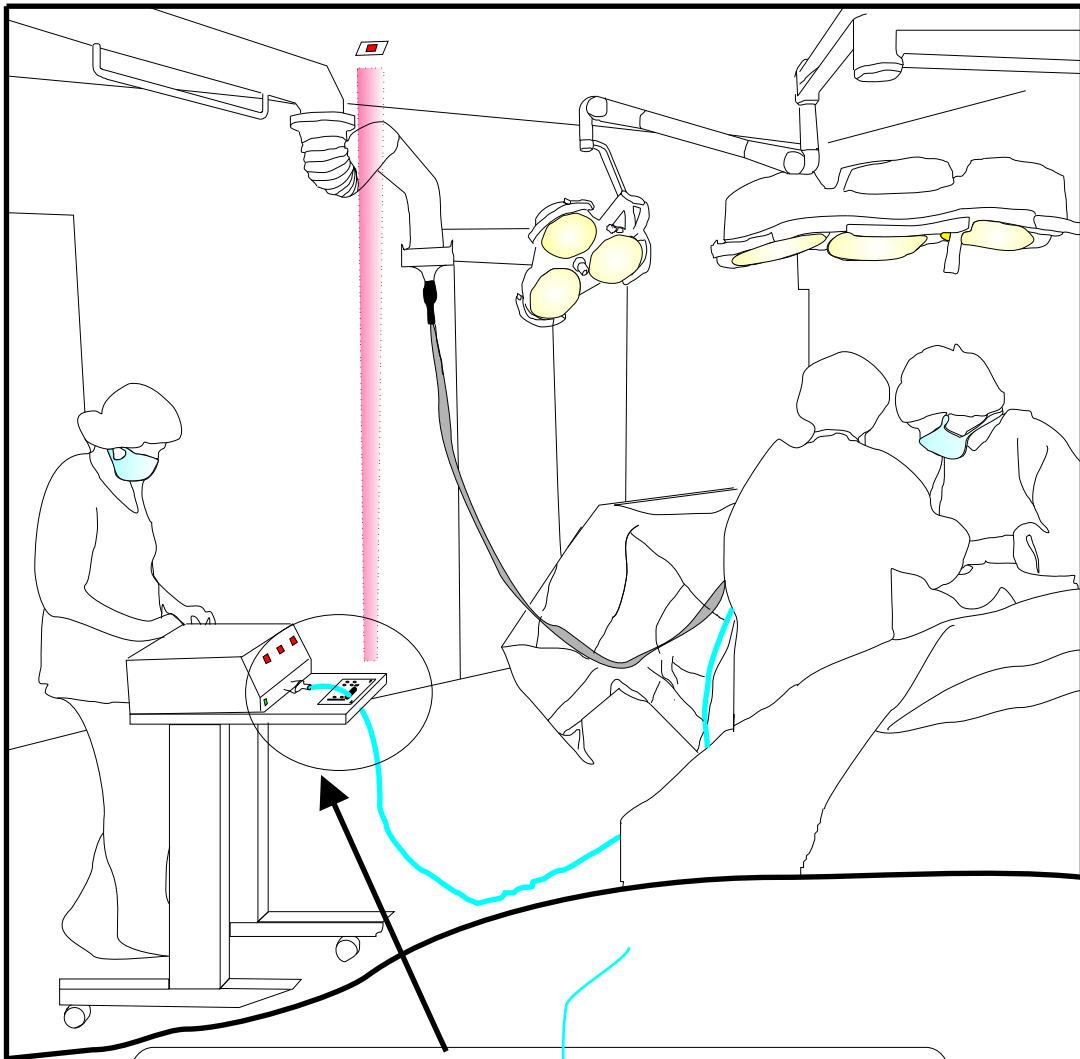

Markeds mest effektive diatermisug

- ♦ Betjenes i nærhed af diatermi- apparatet.
- ♦ Med mulighed for variabel sugestykke

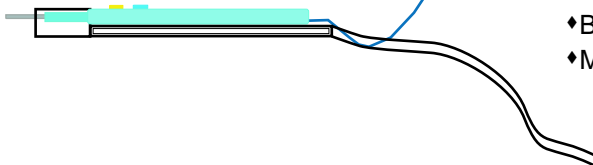

Procesudsug fra EI - kirurgi og laserkirurgi





JRV A/S - Flexoduct Medical
Nimbusvej 10 - DK 2670 Greve
Tlf. 43 950 950 Fax. 43 950 951





Principskitse på diatermisug

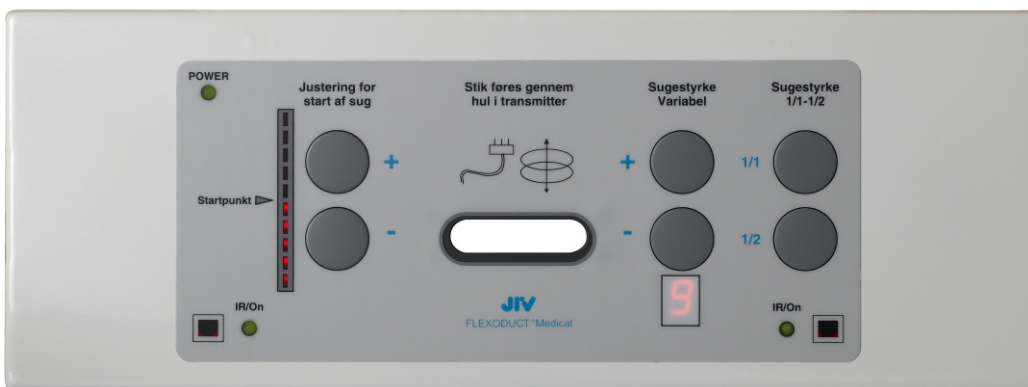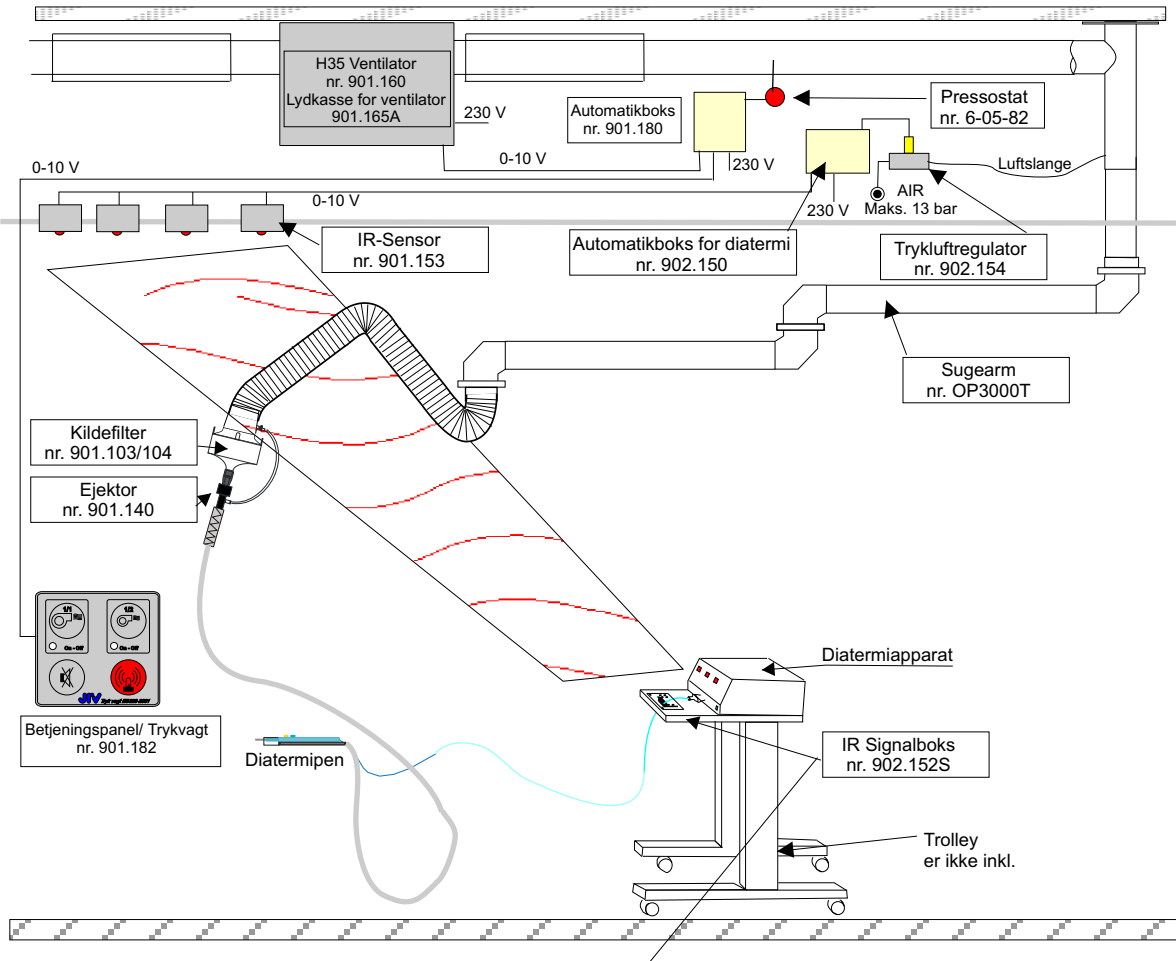




Montage eksempel

IR signalboks

Glidekulisse
Som type :
Uniflex
Duoflex
DIN 10x25

Skinne som type
Uniflex
Duoflex
Din 10x25




IR signalboks monteres med Glidekulisse
Som type :
Uniflex
Duoflex
DIN 10x25
For montage på eksisterende kulisseskinne

Montage eksempel

IR signalboks

Diatermiapparat

Montageplade for IR

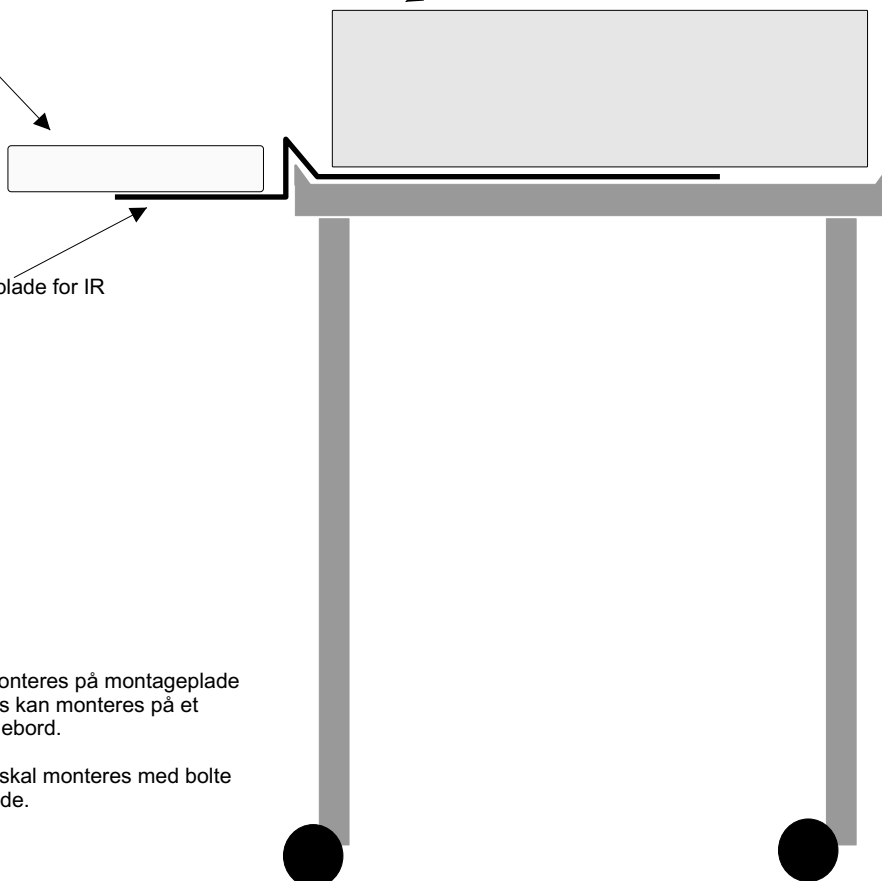

IR signalboks monteres på montageplade
som eksempelvis kan monteres på et
eksisterende rullebord.

Montagepladen skal monteres med bolte
gennem bordplade.